

360°
Gliding
Chair

ingLIFE イングライフ

背合板タイプ

肘なし C05-B10CG(W・U・L)
C05-B10SG(W・U・L)
肘付き C05-B11CG(W・U・L)
C05-B11SG(W・U・L)



背合板タイプ 肘なし
C05-B10CGL

背クッションタイプ

肘なし C05-B10CC(W・U・L)
肘付き C05-B11CC(W・U・L)



背クッションタイプ 肘付き
C05-B11CCW

1. 安全上のご注意

①

2. 末永くご使用いただくためのご注意

③

3. 各部のなまえ

④

4. 使いかた

⑤

5. お手入れのしかた

⑦

6. 故障かな?と思ったら(不調診断)

⑧

7. 部品の交換について

⑨

8. 仕様

⑨

保証について

⑩

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

警告

- 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないでください。

- 主軸内のガススプリングは、絶対に分解や注油をしないでください。

高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをするおそれがあります。

- ガススプリングを絶対に火気の中へ投入しないでください。

破裂によりけがをするおそれがあります。

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

- ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。

- ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。（特にお子様に注意してください。）

- お子様だけで使わせしないでください。けがをするおそれがあります。

- 足が床に届かない状態で座らないでください。（特にお子様に注意してください。）

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。

1.安全上のご注意

- イスのすべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。
- 張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。
内部の構造物により、けがをしたり衣服を損傷する原因になります。
- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座ったりしないでください。
- イスへの着座やイスから立ち上がる際、イスの背、座、肘などイスの1点に体重をかけないでください。
転倒するおそれがあります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。
けがをするおそれがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 座面の端に腰かけないでください。
- 製品を裏返した状態で、昇降レバーを押さないでください。
脚が急に伸びて、けがをするおそれがあります。
- クッションフロアの上で使用しないでください。
床を傷つけることがあります。
- 座るときは、必ずイスを手で引き寄せながら座ってください。
キャスターの転がりにより、イスが逃げるおそれがあります。
- 4本脚の場合、座ったままイスをひきずらないでください。
床を傷つけることがあります。

- 床に適したキャスター・脚先を使用してください。
 - ・ やわらかい床（カーペットなど）… ナイロンキャスター、ナイロン脚先
 - ・ 傷つきやすい床（木質のフローリングなど）… ポリウレタン巻きキャスター、フェルト脚先（オプション）
 - ・ 硬くて滑りやすい床（Pタイル・フローリングなど）… ゴム単輪キャスター、フェルト脚先（オプション）
 - ・ キャスター・脚先交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。
- 必ず一人でお座りください。
- 可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 乱暴な取り扱いや座る用途以外の使用はしないでください。
- イスどうし、イスとテーブルなどが接触すると、傷がつく可能性があります。
- ストープなど火気に近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
早めに締め直してください。
- 溶接外れやキャップ類の欠落などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

1.安全上のご注意

〈使用者の体調に関する注意〉

- 本製品は事務用回転イスです。医療機器ではありません。治療目的での使用はご遠慮ください。
- グライディング機能使用時は、座面が身体の動きに合わせて前後左右に大きく動きます。グライディング機能は、体調と安全に注意の上、無理をせずにご使用ください。
- 下記の方は、グライディング機能を使用する際、必ず医師に相談してください。
 - ・首、肩、背中、腰、脚、手にしびれや痛みなどの異常を感じている、もしくは過去に痛めたことがある方。
 - ・脊髄に疾患がある方


- ・関節に持病などがある方。
- ・座った状態でご自身で身体を支えることができない方。
- ・妊娠中もしくは妊婦と思われる方。
- ・医師から運動を禁じられている方。
- ・その他、身体に異常がある方、または身体に異常を感じられている方。
- 使用中に身体に普段と異なる痛みや違和感、異常を感じたときは、医師にご相談ください。
- 座面が動くことを知らない方、お子様や高齢者が不意な座面の動きによりけが等をされることのないよう、ご注意ください。

2.末永くご使用いただくためのご注意


- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・故障などの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けしないでください。
表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面に、プラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。
塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起すことがあります。
- とときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.各部のなまえ


図は、C05-B11CC(W・U)です。

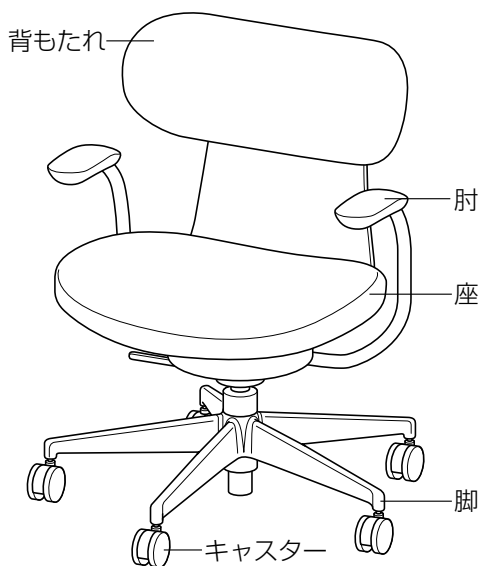

図は、C05-B10CGLです。

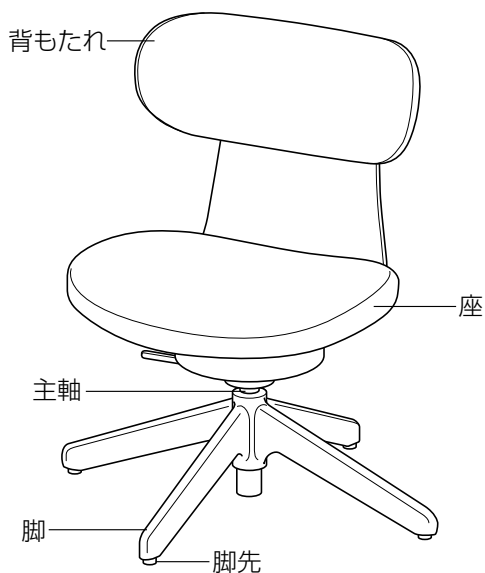

※キャスターは、ナイロンキャスター仕様・ポリウレタン巻きキャスター仕様・ゴム単輪キャスター仕様があります。

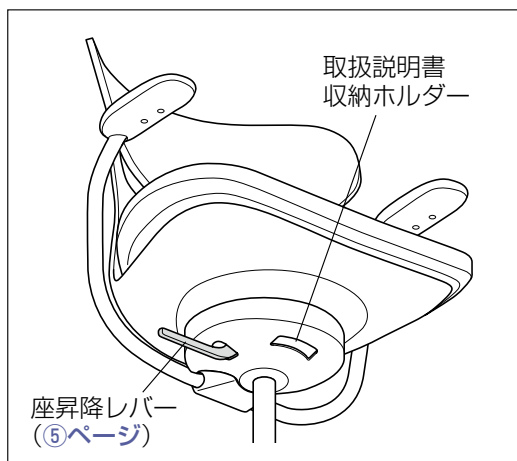

4.使いかた

座昇降レバー



座面下の右手側中央部にある座昇降レバーで、座面の高さ調節ができます。身長やデスクの高さに合わせて調節してください。

座を上げるとき

腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、希望の高さにまで上がったならレバーから手を離します。

座を下げるとき


座の中央に深く腰をかけてレバーを軽く引き上げ、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

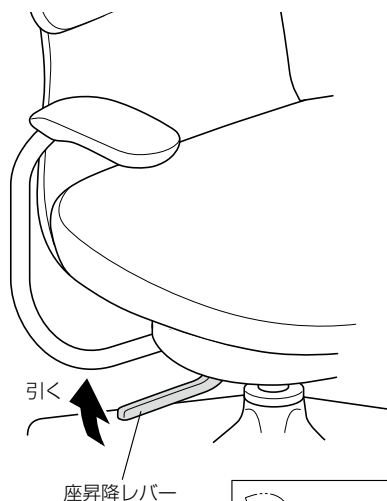


4.使いかた

背座の動き(グライディング)について


この製品には、体の動きに合わせて背と座が前後左右に360°動くグライディング機構を採用しています。

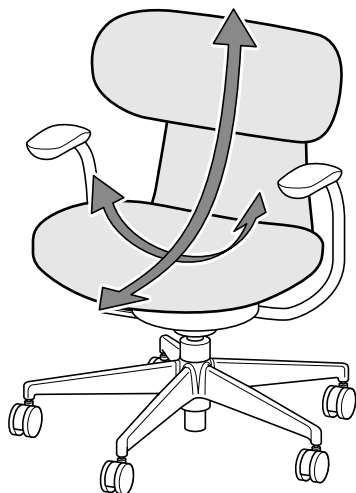

左右の動き

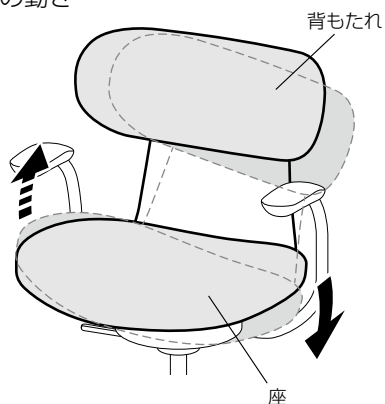


前後の動き

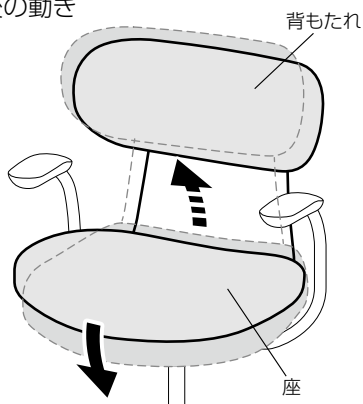

斜め方向の動き

※図は右斜めに傾けた場合です。

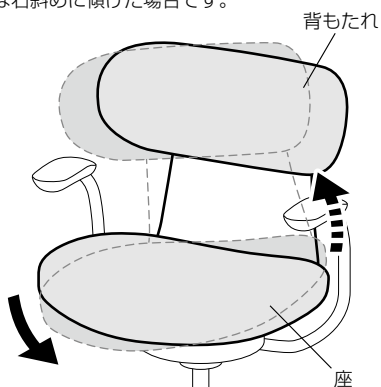

5.お手入れのしかた

① 樹脂部・金属部の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

② 布部の汚れ

日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

③ レザー部の汚れ

日常のお手入れは、レザー部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

■ 消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



6.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	→ こう処置してください
●座が下がらない。	座面の中央に深く腰をかけて、座昇降レバーを操作してください。
●座が上がらない。	座面から腰を浮かせた状態で、座昇降レバーを操作してください。
●キャスターが転がりすぎる。	Pタイルやフローリングなど、硬い床面でお使いになっている場合は、ゴム単輪キャスターをお使いください。
●キャスターの転がりが悪い。	カーペットなど、やわらかい床面でお使いになっている場合は、ナイロンキャスターをお使いください。 キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
●キャスターが転がると「キュル・キュル」と音をする。	キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
●異音をする。	お買い上げの販売店にご相談ください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

△注意
お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

8.仕様

品名		イングライフ					
脚タイプ		5本脚			4本脚		
背タイプ		背クッション	背合板		背クッション	背合板	
品番：C05-		B10CC(W・U) B11CC(W・U)	B10CG(W・U) B11CG(W・U)	B10SG(W・U) B11SG(W・U)	B10CCL B11CCL	B10CGL B11CGL	B10SGL B11SGL
寸法 (mm)	脚部の幅	680			755		
	肘部の幅	630					
	奥行き	535(535～610)	530(530～605)		535(535～610)	530(530～605)	
	高さ	825(825～915)					
	座面の高さ	420(420～510)					

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

寸法 (mm)

品名		イングライフ					
脚タイプ		5本脚			4本脚		
背タイプ		背クッション		背合板	背クッション	背合板	
品番	C05-	B10CC(W-U)	B10CG(W-U)	B10SG(W-U)	B10CCL	B10CGL	B10SGL
		B11CC(W-U)	B11CG(W-U)	B11SG(W-U)	B11CCL	B11CGL	B11SGL
寸法 (mm)	脚部の幅	680			755		
	奥行き	535(535~610)	530(530~605)		535(535~610)	530(530~605)	
	高さ	825(825~915)					
	座面の高さ	420(420~510)					

構造部材

背もたれ部：(クッションタイプ) ポリプロピレン、金属(鋼)
：(合板タイプ) 天然木化粧合板、ポリプロピレン、金属(鋼)

座部：ポリプロピレン

肘掛け部：金属(鋼)

脚部：ナイロン(ガラス繊維入り)

表面加工

肘部：ポリエステル塗装

張り材

品番に**CC-CG**を含むもの：ポリエステル
品番に**SG**を含むもの：合成皮革

クッション材

ウレタンフォーム

取扱い上の注意

直射日光または熱をさけてください。

コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の变色・退色、 レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・ 可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。
10年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。 (オプション、一部の製品を除きます)

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、 コンセント、モーターなど。
----	------	------------------------------------

お試しの電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(セ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ソ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区太今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

